Mode d'emploi court
Modèles 5380, 5380 K à partir de l'année de construction 12/2011

A. Barrières latérales

Relever les barrières latérales

1. Tirez l'élément de la barrière latérale à l'horizontale et de côté jusqu'à la butée, puis basculez-le vers le haut.
2. Pour régler la hauteur des barrières latérales, tirez vers le haut la partie télescopique jusqu'à la butée.

Replier les barrières latérales

1. Appuyez sur les deux boutons qui se trouvent à l'extérieur du longeron (Ill.1), tout près du montant, pour amener la partie téléscopique des barrières dans sa position la plus basse.
2. Actionnez le déclencheur comportant la mention « Drücken / Press » qui se trouve sur la partie inférieure de la barrière latérale (Ill. 2) et basculez-le à l'horizontale de manière à qu'il soit parallèle au sol.
3. Repoussez entièrement l'élément de la barrière sous le plan de couchage (Ill. 3a, Ill. 3b).

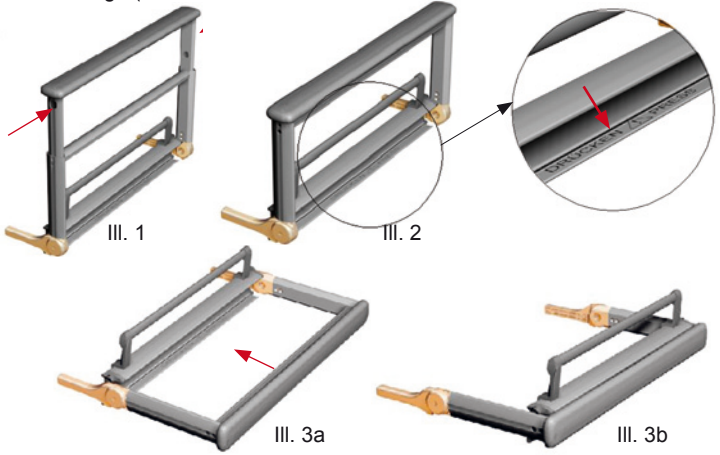

Ill. 1 Ill. 2 Ill. 3a Ill. 3b

B. Télécommande

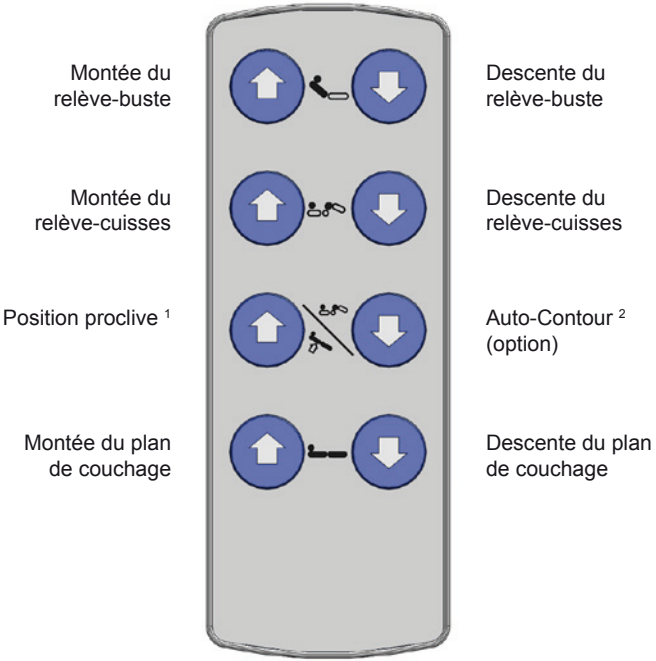

[1] Position tête haute
[2] Elévation simultanée du relève-buste et du relève-cuisses

Völker GmbH • Wullener Feld 79 • 58454 Witten/Allemagne
Téléphone +49 2302 960 96-0 • Fax +49 2302 960 96-16 • www.voelker.de • info@voelker.de

Mode d'emploi court
Modèles 5380, 5380 K à partir de l'année de construction 12/2011

C. Boîtier de contrôle pour personnel soignant avec blocage individuel (en option)

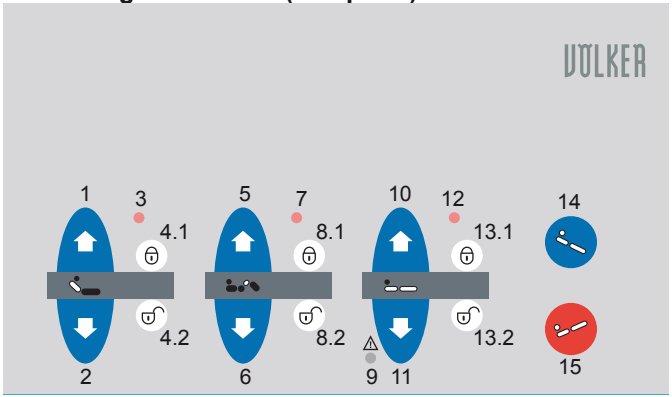

1 Montée du relève-buste
2 Descente du relève-buste
3 LED - verrouillage relève-buste
4.1 Verrouiller le relève-buste
4.2 Déverrouiller le relève-buste
5 Montée du relève-cuisses
6 Descente du relève-cuisses
7 LED - verrouillage relève-cuisses
8.1 Verrouiller le relève-cuisses
8.2 Déverrouiller le relève-cuisses
9 LED - position la plus basse du réglage du plan de couchage
10 Montée du plan de couchage[1]
11 Descente du plan de couchage[1]
12 LED - verrouillage du déplacement en hauteur du plan de couchage
13.1 Verrouiller le déplacement du plan de couchage
13.2 Déverrouiller le déplacement du plan de couchage
14 Position proclive [2]
15 Position déclive[3]

[1] Fonction automatique spécifique au pays possible par un double clic
[2] Position tête haute
[3] Position tête basse

D. Verrouillage des touches

L'activation du verrouillage des touches de la télécommande entraîne le blocage de toutes les fonctions de celle-ci.

Télécommande verrouillée

Télécommande déverrouillée

En cas de verrouillage d'une fonction sur le boîtier de contrôle pour personnel soignant, cette fonction est également bloquée sur la télécommande.

E. Blocage des roulettes

Deux des quatre roulettes pivotantes au niveau du pied sont freinables.
Etrier vers le bas : le lit est bloqué.
Etrier vers le haut : le lit peut être déplacé.

Si le lit n'est pas déplacé, les deux roulettes doivent être bloquées. Dans la version optionnelle, plus facile à manœuvrer, le lit est également équipé de quatre roulettes pivotantes supplémentaires au niveau de la tête qui permettent de ranger le lit à son emplacement. Deux d'entre elles présentent un blocage de la direction. Excepté pendant le déplacement, ce blocage doit également toujours être enclenché.
Le blocage de la direction est correctement fixé lorsque les leviers à pédale sont abaissés et que l'enclenchement des roulettes, parallèle au côté longitudinal du lit, est audible après une légère rotation.

REMARQUE Le lit n'est pas adapté au nettoyage dans un tunnel de lavage (IPX4) et ne doit pas être utilisé pour le transport de résidents / patients.

REMARQUE Veuillez observer les remarques figurant dans le manuel d'utilisation détaillé !

Völker GmbH • Wullener Feld 79 • 58454 Witten/Allemagne
Téléphone +49 2302 960 96-0 • Fax +49 2302 960 96-16 • www.voelker.de • info@voelker.de

CE

KA213 - V1.0 (24.04.2012)